
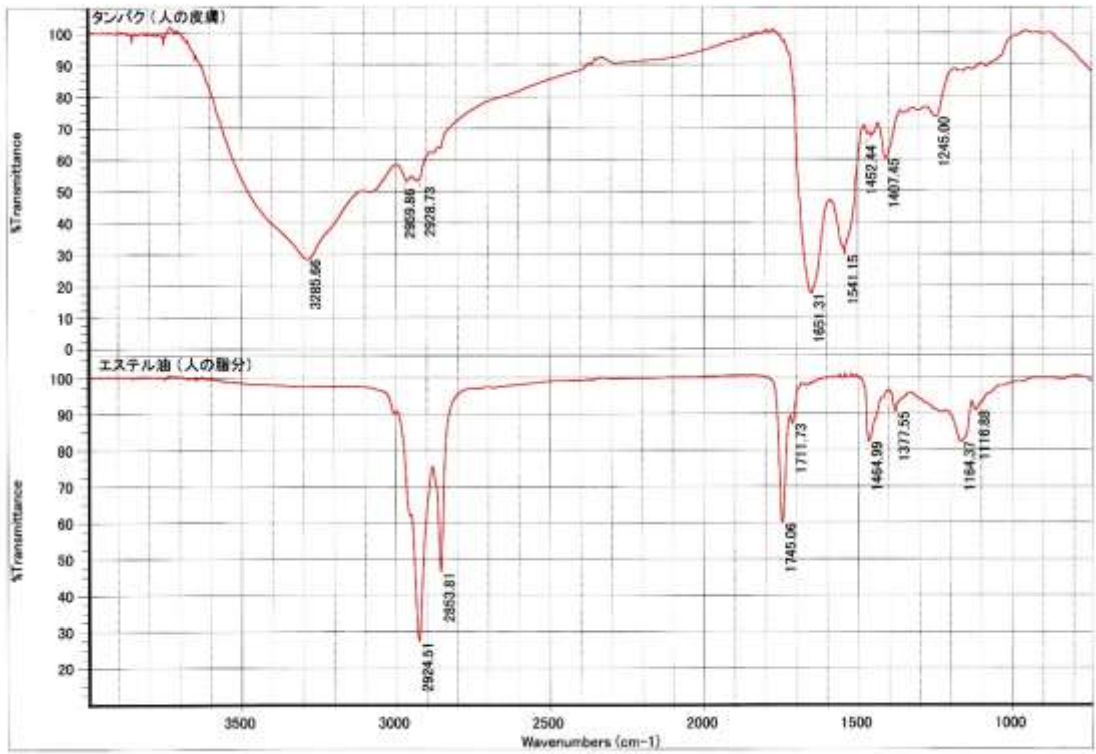


Technical Report

人体からの汚染物の分析 <<株式会社コーエキ>>		3003 FTIR/赤外分析
試料情報	皮膚、人脂	
装置名	フーリエ変換型赤外分光光度計 (Avatar 360) 赤外顕微鏡 (ニコレーContinuum)	
測定条件	顕微透過法	
備考		
測定結果		
備考		