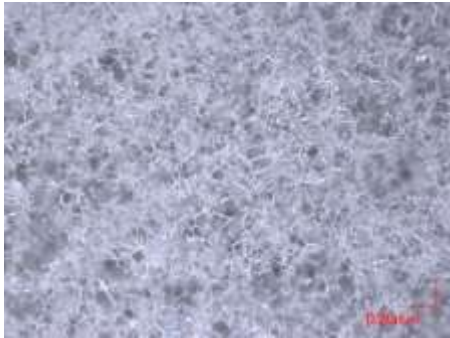
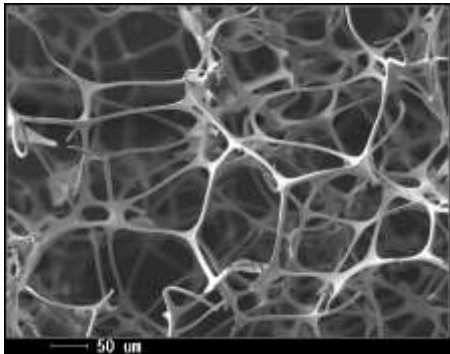
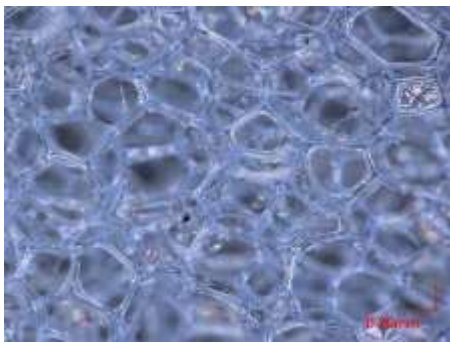
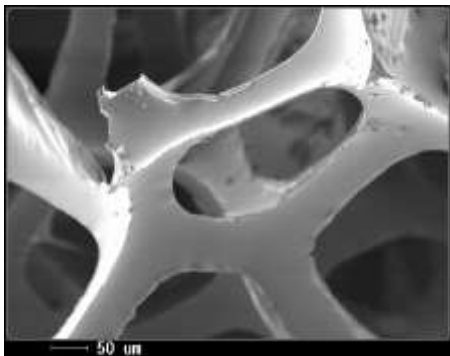
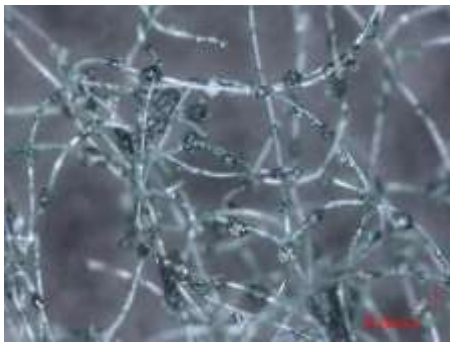



Technical Report

スポンジの観察 <<株式会社コーエキ>>		6007 EPMA/VHX
試料情報	メラミンスポンジ、スポンジ、ナイロンタワシ	
装置名	デジタルマイクロスコップ (VHX-1000) 電子線マイクロアナライザー (EPMA-1610)	
測定条件	金蒸着、5Kv	
備考		
測定結果	メラミンスポンジ	 
	スポンジ	 
	ナイロンタワシ	 

株式会社コーエキ — 総合分析と評価 —

長野県岡谷市田中町三丁目 3-24 TEL 0266-23-2155 FAX 0266-23-0733

e-mail : info@e-koeki.co.jp URL : <http://www.e-koeki.co.jp/index2.htm>